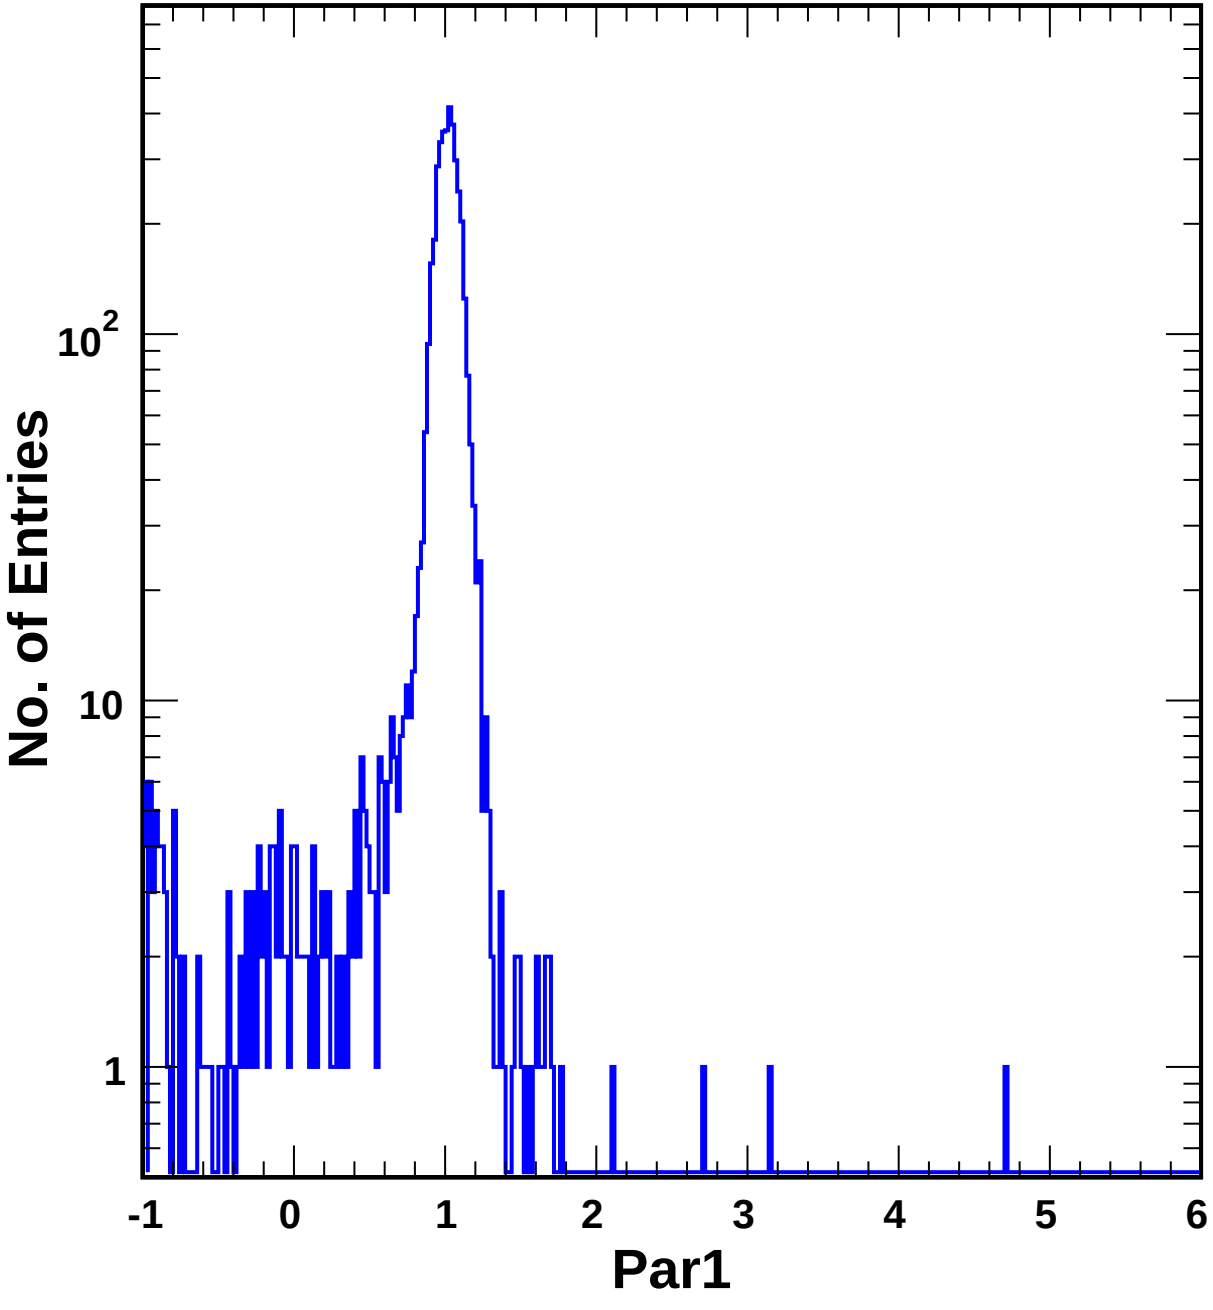PHCalibrationParameter1